


LOCAL/AMBIENTE	BLOCO GINÁSIO - LABORATÓRIO DE ANÁLISE INSTRUMENTAL (Depto. de Química)	Nº DE SERVIDORES EXPOSTOS	4
----------------	--	---------------------------	---

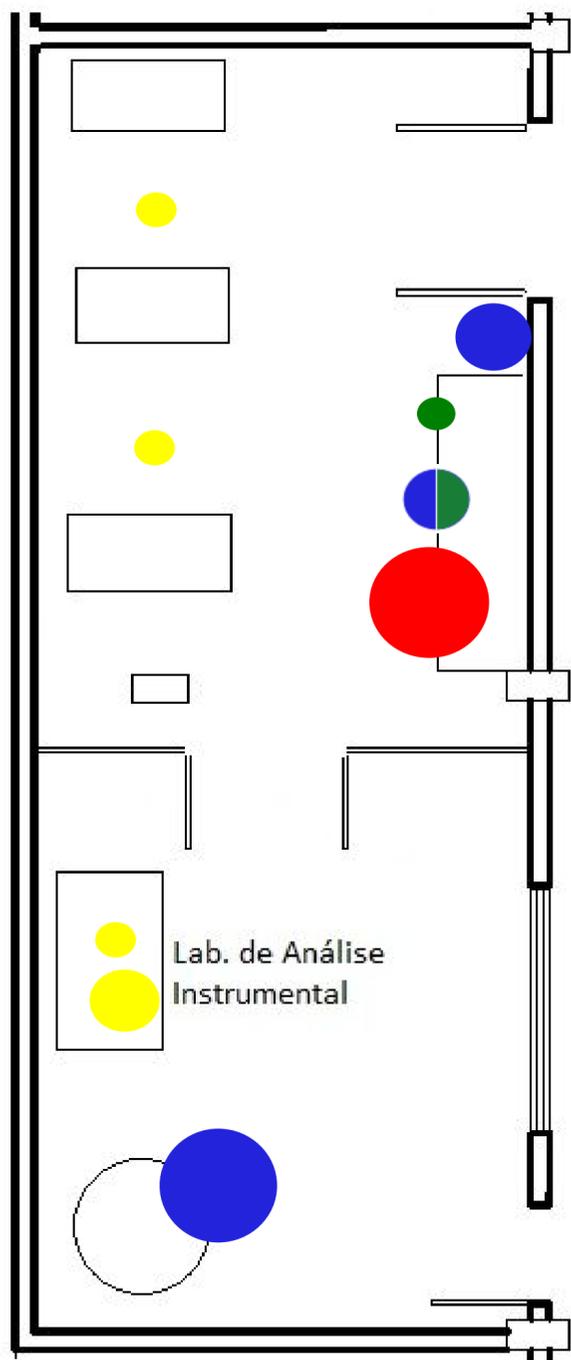

RISCOS	AGENTES/FONTES	GRAU de RISCO	RECOMENDAÇÕES para PREVENIR ACIDENTES
FÍSICO	Ruído do exaustor da capela que será instalada	Pequeno	Usar protetor auricular se houver exposição prolongada
FÍSICO	Prejudicial contato das mãos com amostras	Médio	Usar luvas de proteção
QUÍMICO	Aerodispersóides, gases e vapores	Grande ou Grave	Uso de máscaras de proteção. Manipular produtos dentro da capela com exaustor
QUÍMICO	Reagentes em geral	Grande ou Grave	Manipular dentro da capela. Usar luvas e máscaras com filtro. Providenciar a FISPQ (ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) de todos os produtos químicos e deixar disponível em local bem visível.
ERGONÔMICO	Trabalho sentado predominantemente	Pequeno	Alternar postura em pé e sentada
ERGONÔMICO	Vícios posturais durante a digitação e uso do computador	Médio	Manter postura correta com coluna ereta, braços e pernas com um ângulo de 90° 
ERGONÔMICO	Mobílias e cadeiras inergonômicas	Pequeno	Instalar mobílias/cadeiras com características ergonômicas
ACIDENTE	Manipular vidrarias	Médio	Cuidado para não quebrar vidrarias, evitando cortes.
ACIDENTE	Manipular nitrogênio líquido / hélio líquido do equipamento de Ressonância Magnética Nuclear - RMN	Grande ou Grave	Usar jaleco, luvas e óculos de proteção. Risco de respingo que causam queimaduras e podem atingir os olhos.
ACIDENTE	Risco de incêndio	Médio	Manter extintor no interior do laboratório.

LEGENDA

Grupos de Risco ■ Risco Físico ■ Risco Químico ■ Risco Biológico ■ Risco Ergonômico ■ Risco de Acidente	Grau de Risco de Acidentes e Doenças do Trabalho Pequeno Médio Grande ou Grave
---	--

EPIs

